


Case : 22

空気を注入するためのバルブが腿（もも）にあたり、痛みが生じる

### 場面の説明

サイズの合っていないクッションを使用していて空気注入口が腿（もも）にあたったまま、長時間車いすに座っていた

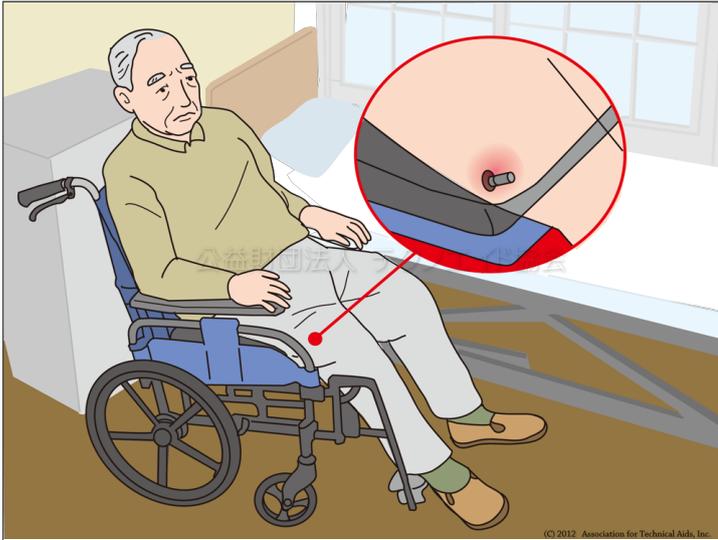

利用シーン	 移動
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 車いす付属品
分類コード (CCTA95)	122406 (シート (座)・背もたれ・車いす用パッド・クッション)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

クッション自体は本来このようなことが起こらないように設計されていますが、利用者の座位姿勢、車いすとクッションの適合、クッションの間違った使い方などにより、このような危険が生じる場合もあります。利用者の中には自らこのような危険を訴えることが出来ない方もいらっしゃいますので、介助者も定期的の確認しましょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：少くらいサイズが違っていても大丈夫だろうと油断していた
- モノ：クッションが適切な位置からずれていた
- 環境：福祉用具について適切なアドバイスのできる人が周囲にいなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 22

空気を注入するためのバルブが腿（もも）にあたり、痛みが生じる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

サイズの合っていないクッションを使用していて空気注入口が腿（もも）にあたったまま、長時間車いすに座っていた



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ